

# 決算報告会

2018年10月31日

株式会社カインス  
代表取締役社長  
上地 史朗

# 2018年度 情報開示

1. 血栓性血小板減少性紫斑病の体外診断用医薬品  
保険適用のお知らせ (2018年 4月 2日)
2. 2018年 3月期決算短信(非連結) (2018年 5月 9日)
3. 役員の変動に関するお知らせ (2018年 5月28日)
4. 有価証券報告書の届出 (2018年 6月22日)
5. コーポレートガバナンス報告書の届出 (2018年 6月22日)
6. 2019年 3月期 第1四半期決算短信 (2018年 7月25日)
7. 2018年 第1四半期報告書 (2018年 8月 3日)
8. 業績予想の修正に関するお知らせ (2018年 9月25日)
9. 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による  
自己株式の買付けに関するお知らせ (2018年 9月25日)
10. 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び  
自己株式の取得終了並びに主要株主の変動に関するお知らせ  
(2018年 9月26日)

# 2018年度情報開示

## 業績予想の修正に関するお知らせ

(情報開示日:平成30年9月25日)

平成31年3月期第2四半期(累計)個別業績予想数値の修正(平成30年4月1日～平成30年9月30日)

(単位:百万円、%)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益 (円)
前回発表予想 (A)	2,270	230	230	155	37.08
今回修正予想 (B)	2,270	290	290	200	47.85
増減額 (B)-(A)	-	60	60	45	-
増減率 (%)	-	26.1	26.1	29.0	-
(ご参考) 前期第2四半期実績 (平成30年3月期第2四半期)	2,006	161	180	126	30.38

# 2018年度情報開示

## 業績予想の修正に関するお知らせ

(情報開示日:平成30年9月25日)

平成31年3月期通期個別業績予想数値の修正(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:百万円、%)


	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益 (円)
前回発表予想 (A)	4,700	400	400	280	66.98
今回修正予想 (B)	4,800	500	500	350	83.73
増減額 (B)-(A)	100	100	100	70	-
増減率 (%)	2.1	25.0	25.0	25.0	-
(ご参考)前期実績 (平成30年3月期)	4,386	456	477	277	66.49

# 2018年度上期決算

売上高(主要検査分野別)

(単位:百万円)

■ 予想 ■ 実績

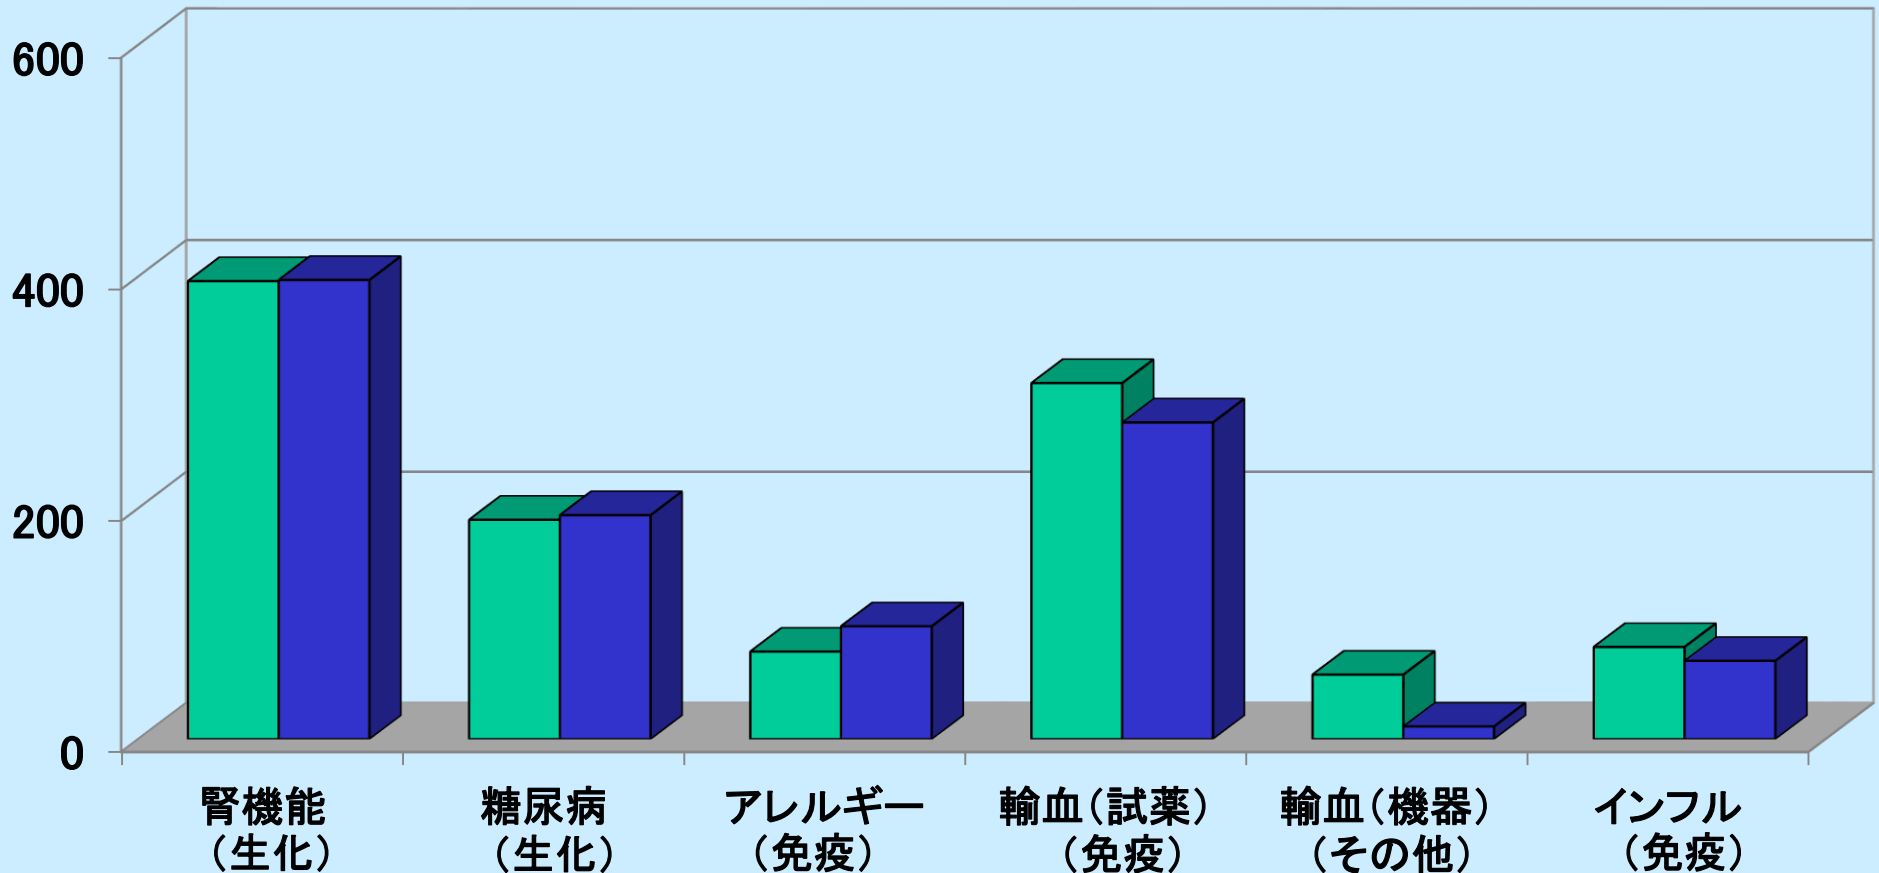


# 2018年度上期決算

売上高(検査分野別)


(単位:百万円)

■ 予想 ■ 実績

予	想	: 2, 270
実	績	: 2, 254

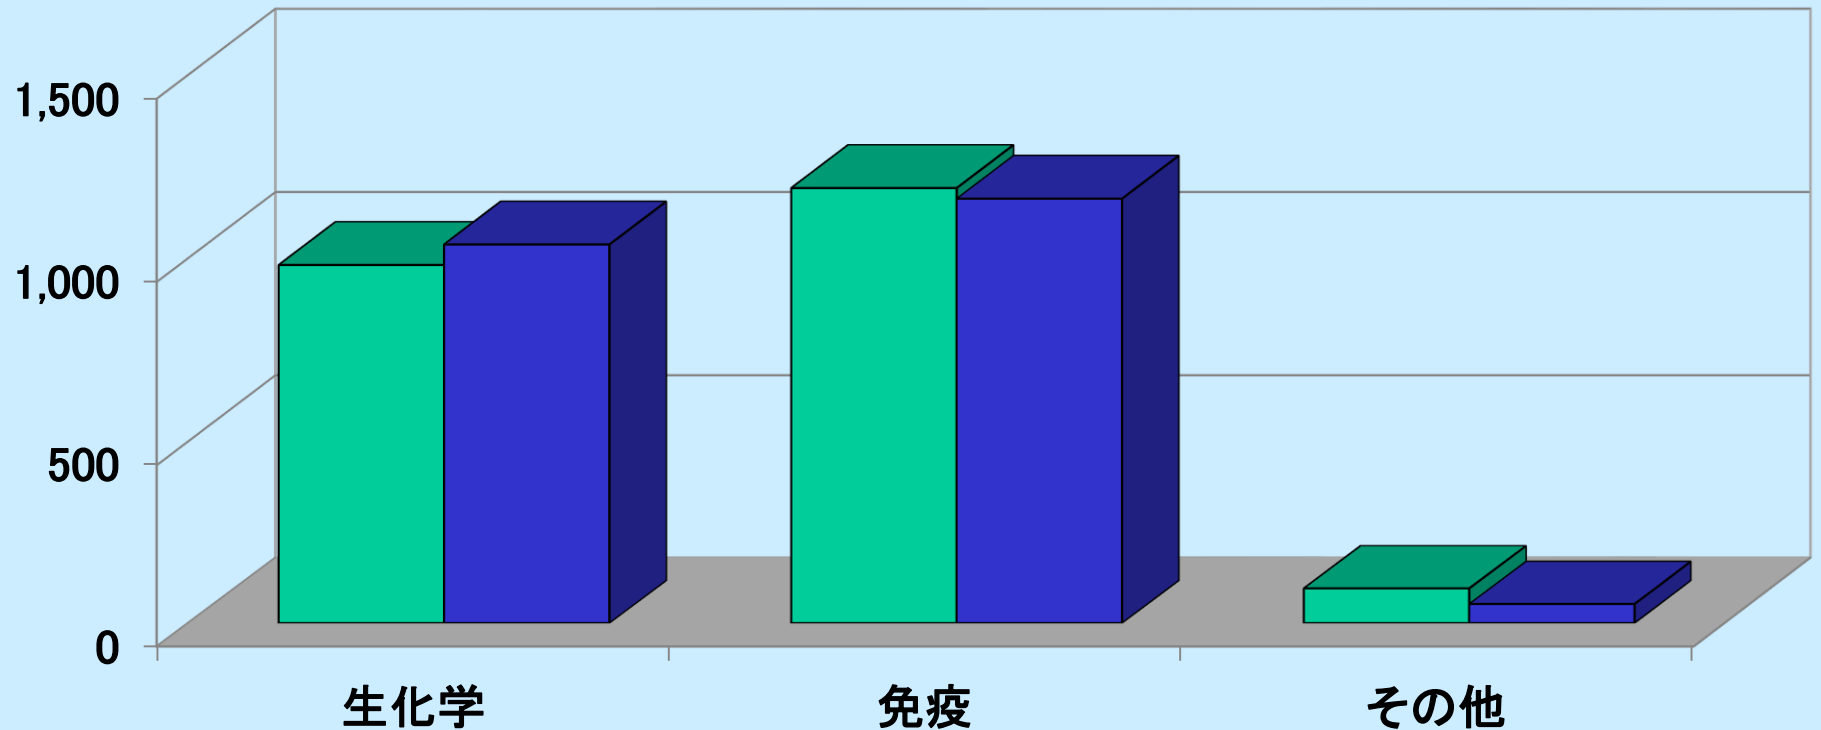

# 2018年度 上期決算

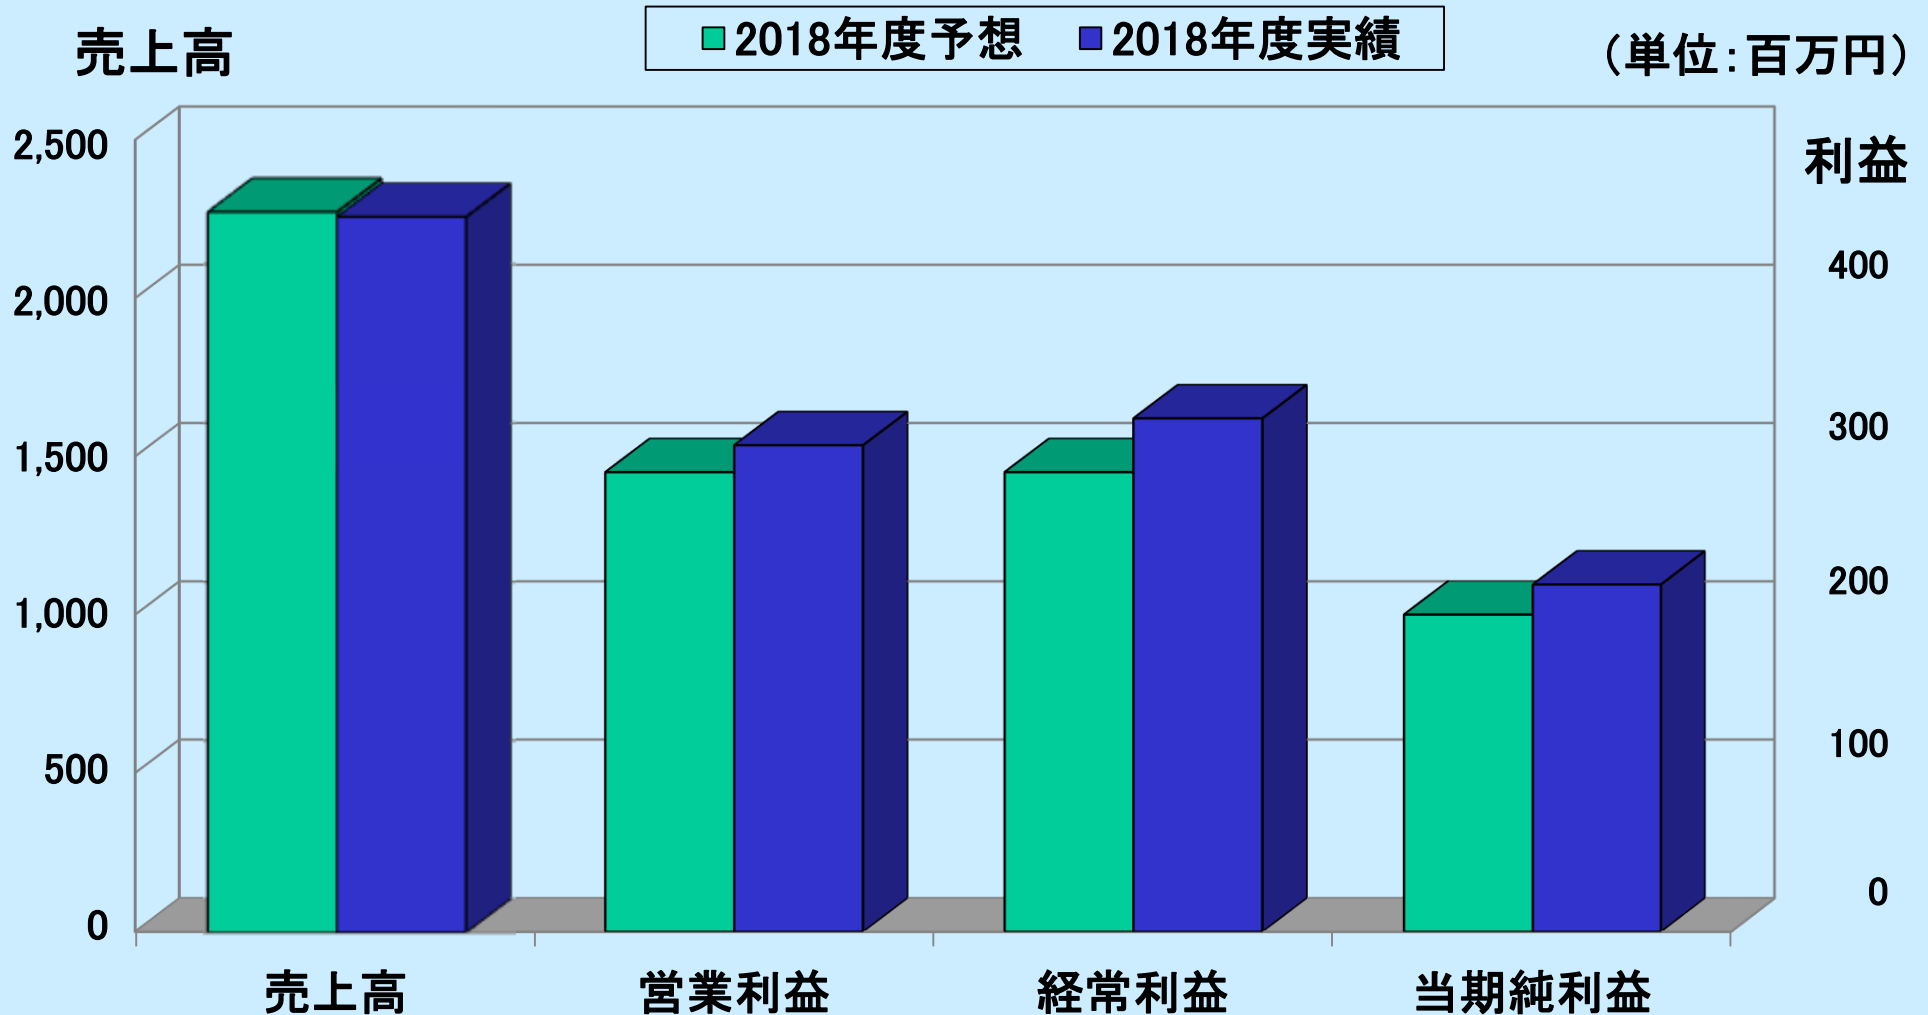

# 2018年度 上期決算

(単位:百万円)

		2018年度 上期 予想	2018年度 上期 実績	増減額	増減率 (%)
売上高	製品	1,651 (72.7%)	1,663 (73.8%)	12	0.7
	商品	619 (27.3%)	591 (26.2%)	▲ 28	▲4.5
	計	2,270 (100.0%)	2,254 (100.0%)	▲16	▲0.7
営業利益		290	307	17	5.9
経常利益		290	324	34	11.7
当期純利益		200	219	19	9.5



# 2018年度の課題と対策(上期結果)

## 1. 輸血項目の拡大

### 1) 機器拡販

- ・機器使用施設: 400台以上の設置  
⇒ 既存289台 + 新規12台設置 (合計 301台)
- ・学会での展示、ユーザーデモの実施  
⇒ 5/24~26: 日本輸血・細胞治療学会総会にて展示  
⇒ 19施設でデモの実施
- ・新機種の上市  
⇒ 「Erytra Eflexis」 9/2上市  
5月の日本輸血・細胞治療学会  
総会にて参考展示



# 2018年度の課題と対策(上期結果)

## 1. 輸血項目の拡大

### 2) 顧客満足度の向上

- ・学会でのセミナー実施


⇒5/25: 日本輸血・細胞治療学会総会では  
「ADAMTS13」のセミナー実施

- ・ユーザー会の実施

⇒機器新発売記念講演会として  
11/15に実施予定

# 納入施設マップ（輸血機器）

設置台数：301台

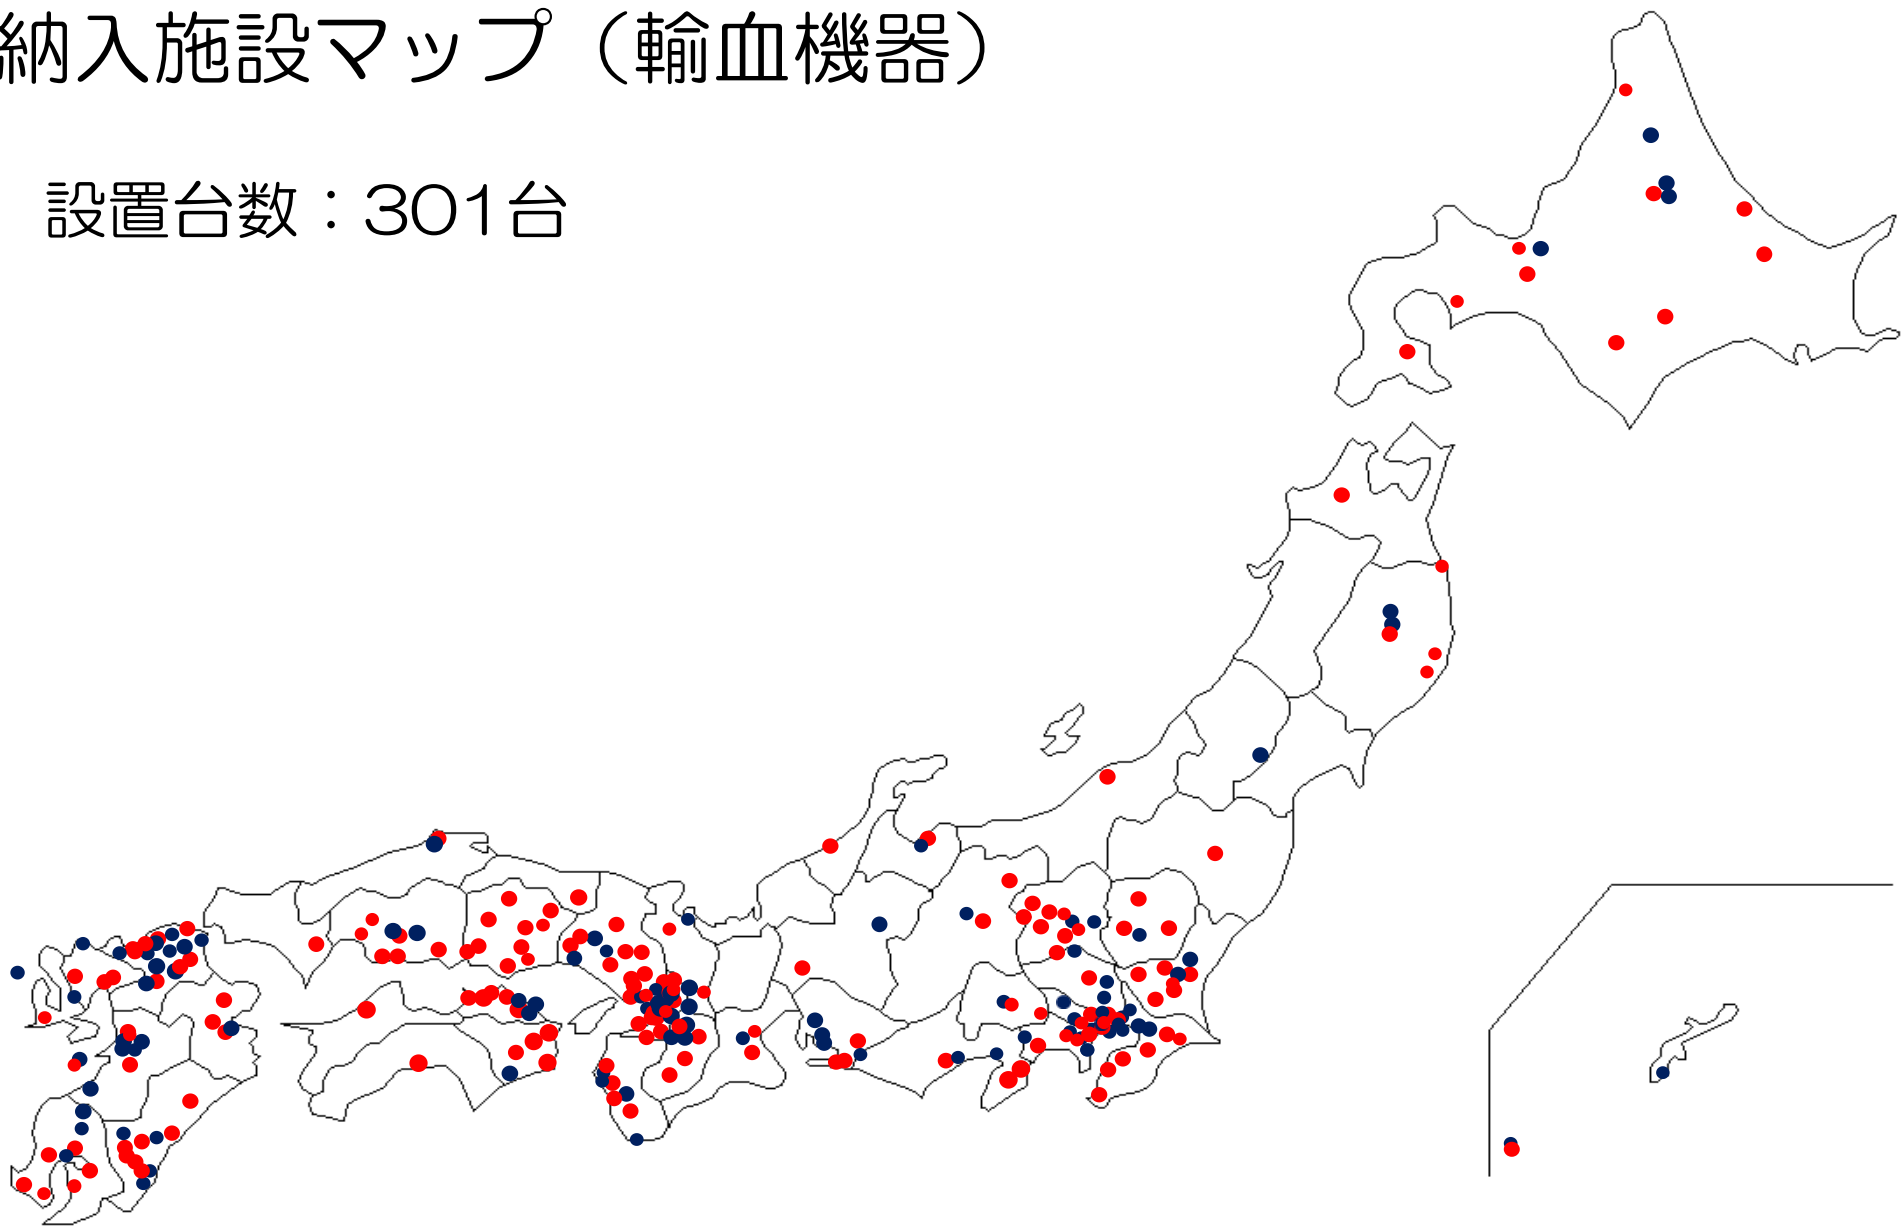


# 2018年度の課題と対策(上期結果)

## 2. 基幹システムの更新と運用



### 1) 生産管理システム

- ・2018年4月  
切替・運用開始

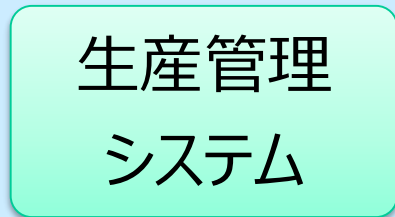

### 2) 販売管理システム

- ・2019年4月更新
- ・2018年度：  
単体・結合テスト 済  
運用テスト(10-12月)  
並行稼働(1-3月)

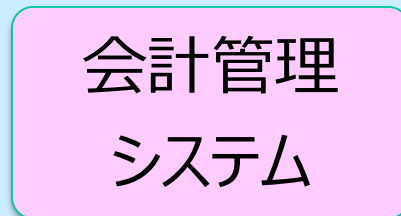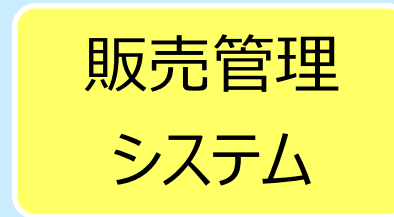

### 3) 会計管理システム

- ・両システムとの連携
- ・自動仕訳等のインターフェース  
確認/検証

# 2018年度の課題と対策(下期課題)

## 1. 輸血項目の拡大

### 1) 機器拡販

- ・機器使用施設: 400台以上の設置(下期新規100台)
- ・新機種「Erytra Eflexis」の拡販
  - ①10/11~13: JACLaSにて正式展示
    - 10/12: 自動化学会にて機器紹介セミナー実施
  - ②11/15 : 「Erytra Eflexis新発売記念講演会」実施  
(ユーザー使用経験の報告等)

### 2) 顧客満足度の向上

- ・サーベイ実施: 11月実施

# トピックス

## 「Erytra Eflexis新発売記念講演会」 (エリトラ エフレクシス)



# Erytra Eflexisシステムの紹介

## ～特徴～

1. 検査室のスペースに制限されることのない、洗練された卓上型コンパクトサイズ
2. 試薬、検体設置ラックが4か所、遠心機2台、恒温槽3台装備し、各顧客の使用状況に応じた効率的な運用が可能
3. 専用ボタンを押すだけで緊急検体に対し、優先的に検査を実施
4. 見やすいタッチスクリーンによる簡便な操作性

200～600床が2400施設（機器稼働745台）

今後、輸血機器導入・更新施設が多数見込まれる

・ユーザー状況


1. 検査室が狭い
2. 検体数は少ないが、検査項目は大病院と同じ
3. 人員は少ないが、夜間対応、緊急対応は必要
4. 12月の医療法改正で精度管理の徹底が要求される

Erytra Eflexisは200～600床クラスの  
病院に最適の機器である



## プロモーション活動

- ・9月2日 上市 ユーザーへの紹介開始
- ・日本輸血・細胞治療学会(5月24～26日)に参考展示
- ・本社4Fショウルームにてユーザーへの機器性能説明実施中
- ・11月15日「Erytra Eflexis新発売記念講演会」実施

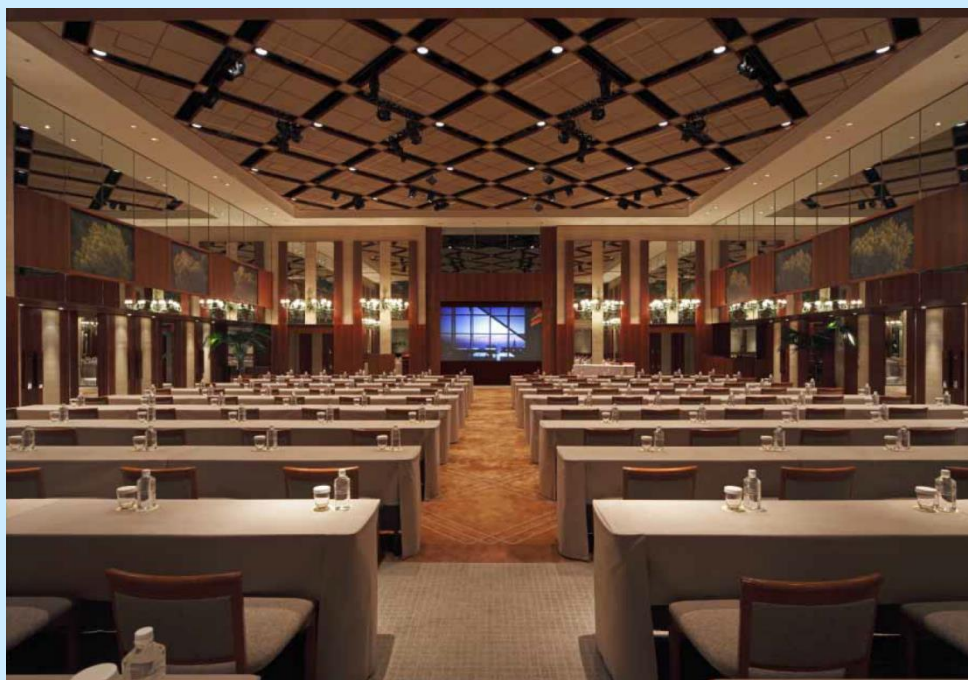

# 「Erytra Eflexis新発売記念講演会」

- ・ 開催日:11月15日
- ・ 場 所:新宿「パークハイアット東京」
- ・ 招待者数:120名
- ・ 演題
- ・ 1.『全自動輸血検査装置Erytraの使用経験』  
熊本赤十字病院 検査部 吉田 雅弥先生
- ・ 2.『全自動輸血検査装置Erytra Eflexisのご紹介』  
株式会社カインス 学術部 中島 康裕
- ・ 3.『全自動輸血検査装置Erytra Eflexisの使用経験』  
順天堂大学医学部附属順天堂医院  
臨床検査部 輸血・セルプロセッシング室 兼松 健也先生
- ・ 4.『全自動輸血検査装置Erytra Eflexisの使用経験』  
東京医科歯科大学医学部附属病院 輸血・細胞治療センター 大友 直樹先生

# 販売方針

1. ErytraとEflexisは操作性が近似しており、両機併用でもユーザー使用時に負担が掛からない
2. 昼間(検体数が多い)、夜間(検体数が少)で、施設状況に応じ、両機を使い分けることが可能

- 施設規模に合わせた提案が可能

- 1. 500床以上の病院
  - Erytra2台
  - Erytra1台+Eflexis1台
  - Eflexis2台
- 2. 200～500床の病院
  - Eflexis2台
  - Eflexis1台
- 3. 検査センター
  - Erytra複数台+Eflexis1台

# ご提案構成例

	品名	規格
輸血検査装置一式	全自動輸血検査装置 Erytra	2台
	カード用インキュベーター DG Therm	1台
	カード用遠心機 DG Spin	1台



Erytra

	品名	規格
輸血検査装置一式	全自動輸血検査装置 Erytra Eflexis	2台
	カード用インキュベーター DG Therm	1台
	カード用遠心機 DG Spin	1台



Erytra Eflexis

	品名	規格
輸血検査装置一式	全自動輸血検査装置 Erytra	1台
	カード用インキュベーター DG Therm	1台
	カード用遠心機 DG Spin	1台



Erytra

	品名	規格
輸血検査装置一式	全自動輸血検査装置 Erytra Eflexis	1台
	カード用インキュベーター DG Therm	1台
	カード用遠心機 DG Spin	1台



Erytra Eflexis

	品名	規格
輸血検査装置一式	全自動輸血検査装置 Erytra	1台
	全自動輸血検査装置 Erytra Eflexis	1台
	カード用インキュベーター DG Therm	1台
	カード用遠心機 DG Spin	1台



Erytra



Erytra Eflexis


# 2018年度予想

# 2018年度予想

売上高(主要検査分野別)

(単位:百万円)

■ 2017年度実績 ■ 2018年度当初予想 □ 2018年度上期実績 ■ 2018年度下期予想

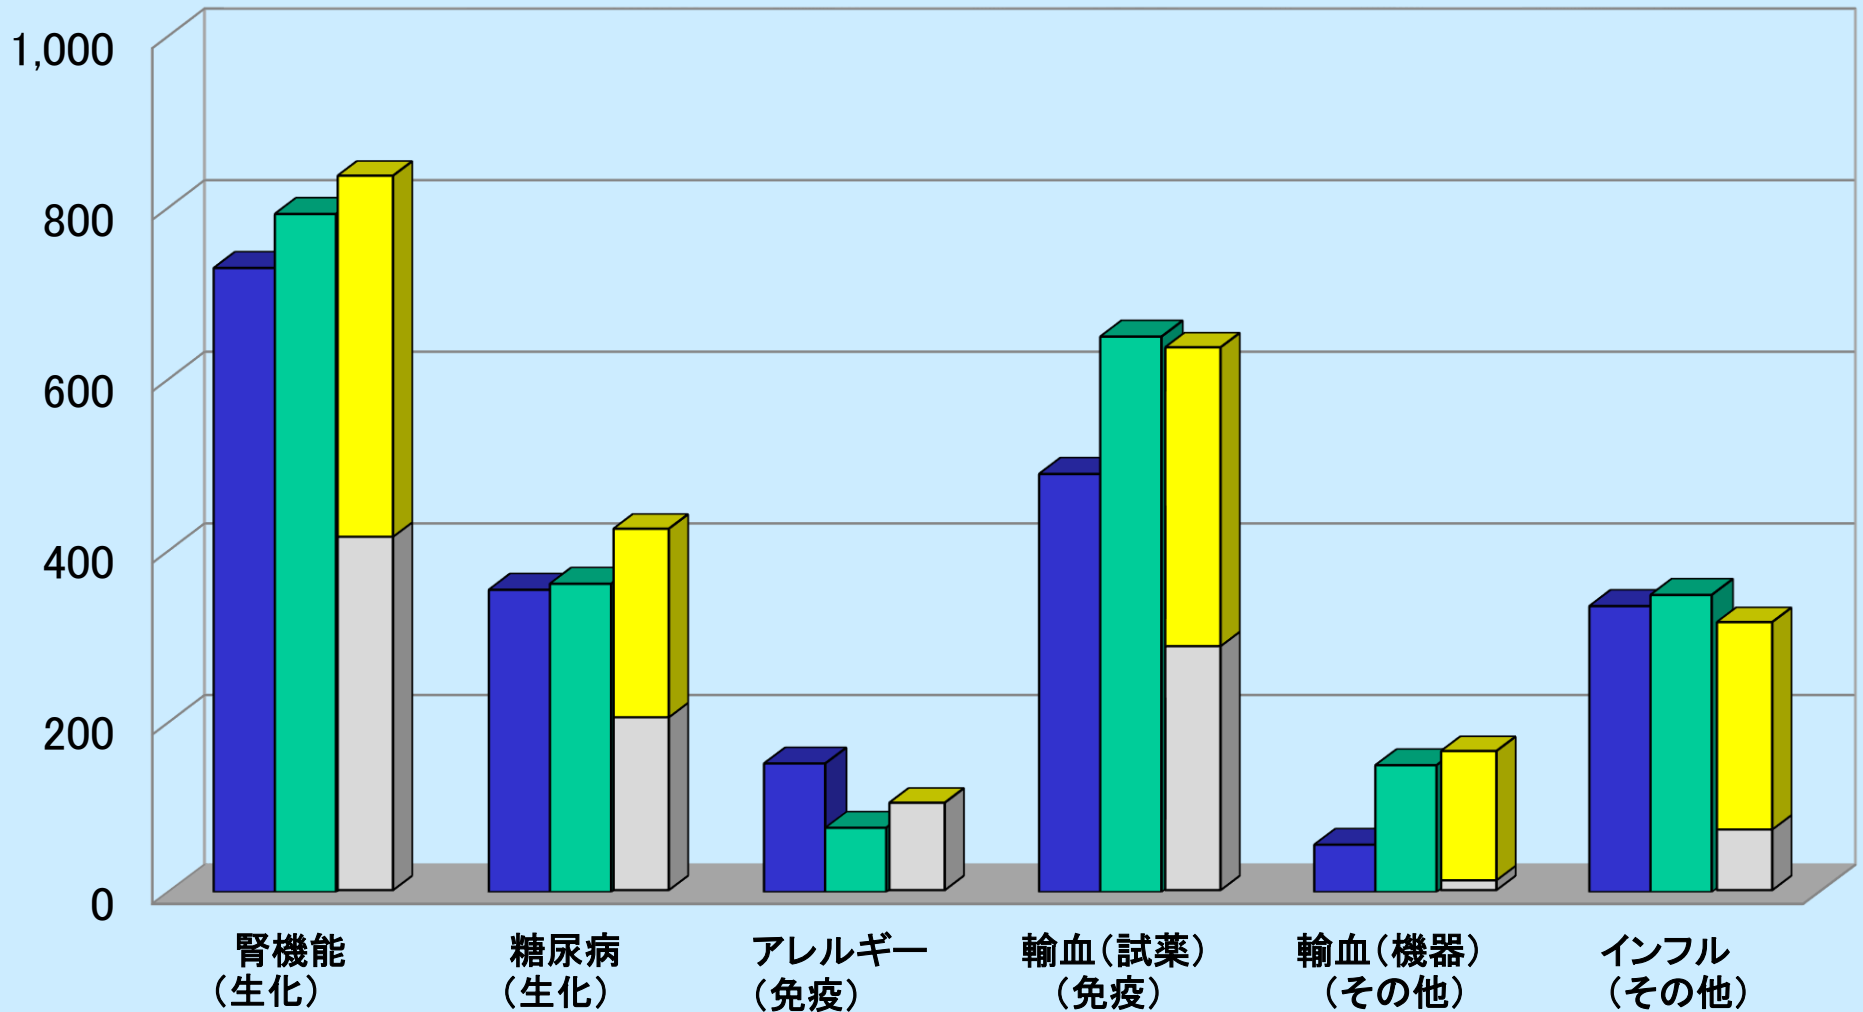


# 2018年度予想

売上高(検査分野別)


(単位:百万円)

■ 2017年度実績 ■ 2018年度当初予想 □ 2018年度上期実績 ■ 2018年度下期予想

前年実績 : 4,386  
予 想 : 4,800

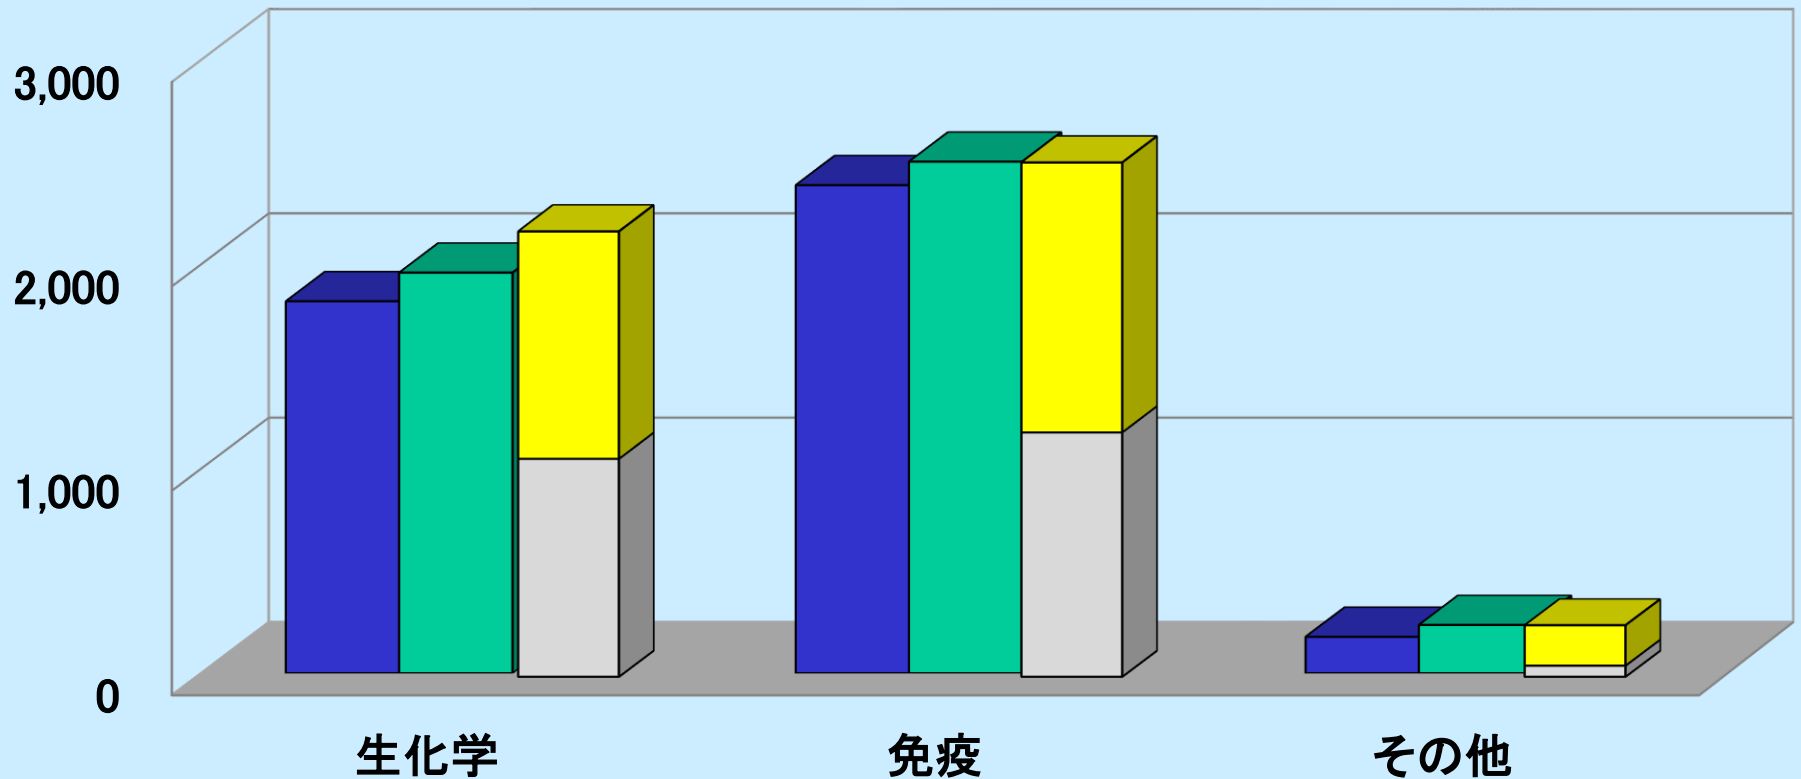

# 2018年度 通期予想

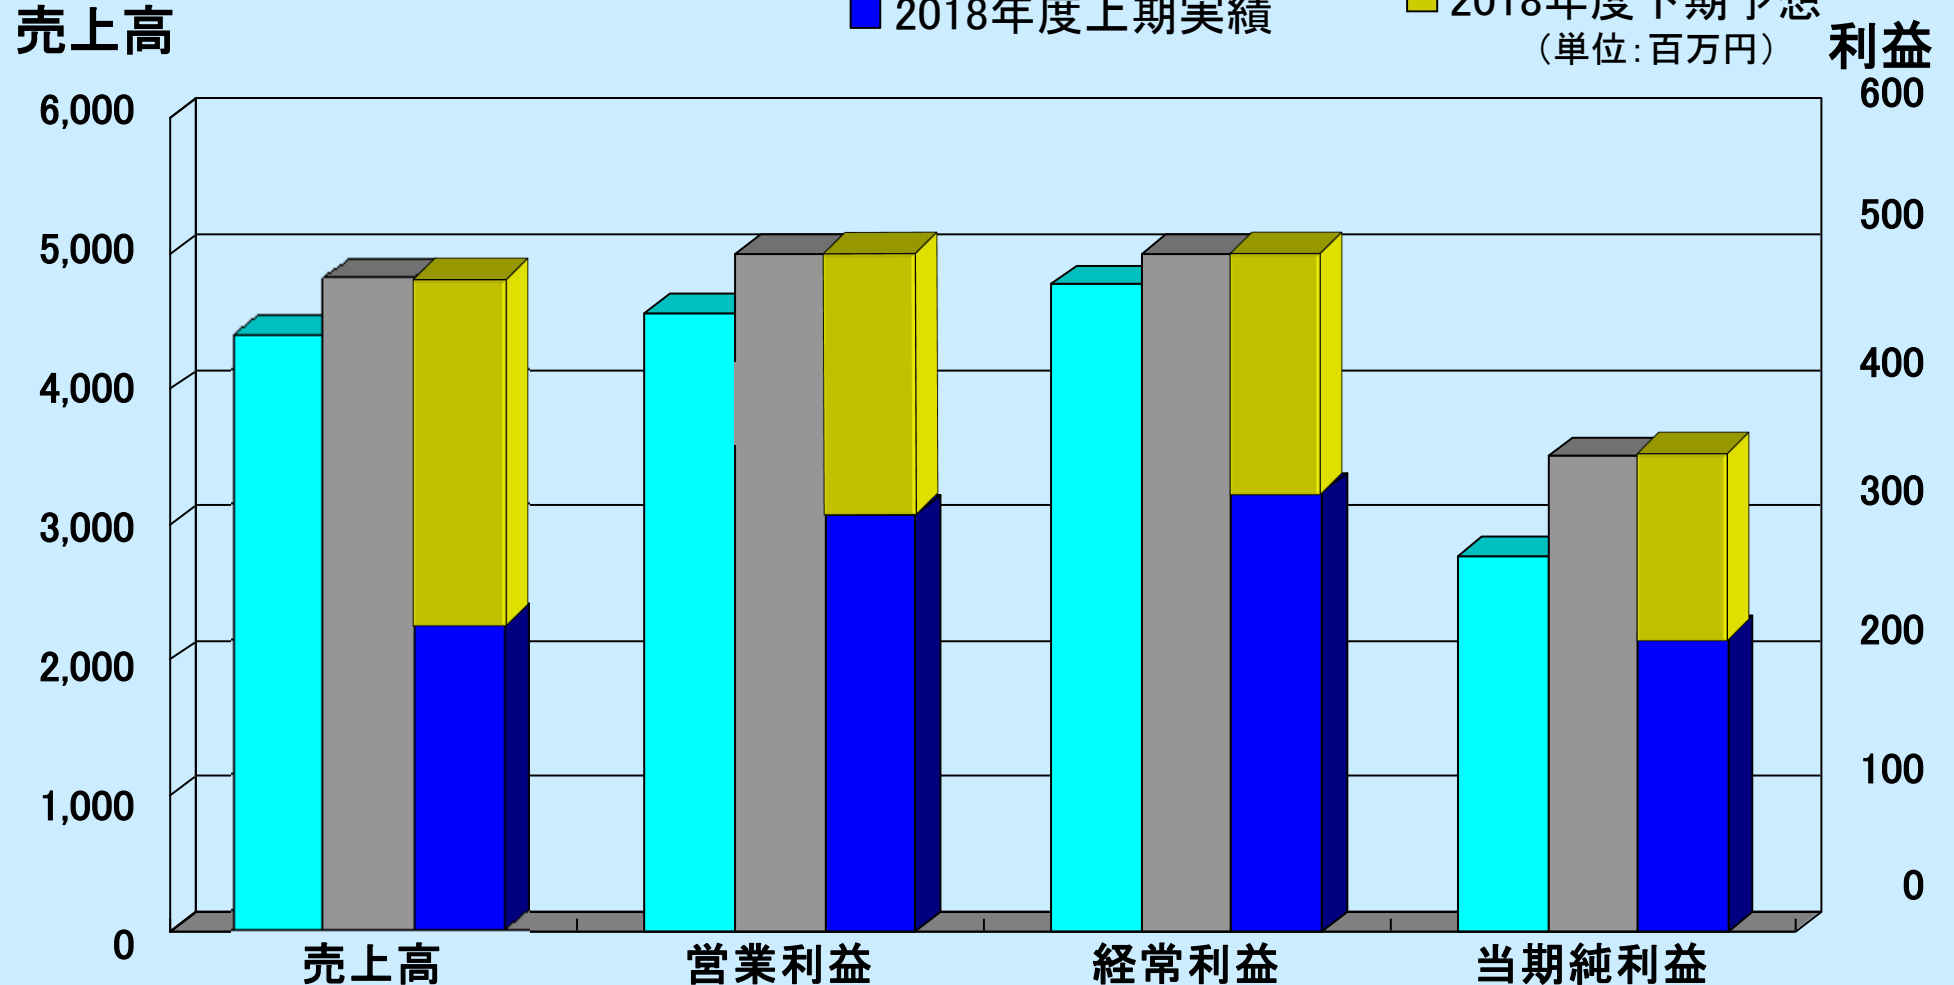




# 2018年度 通期業績予想


(単位:百万円)

		2017年度通期 実績	2018年度通期 予想	増減額	増減率 (%)
売上高	製品	2,992 (68.2%)	3,519 (73.3%)	527	17.6
	商品	1,393 (31.8%)	1,281 (26.7%)	▲112	▲8.0
	計	4,386 (100.0%)	4,800 (100.0%)	414	9.4
営業利益		456	500	44	9.6
経常利益		477	500	23	4.8
当期純利益		277	350	73	26.4


# 損益分岐点の推移

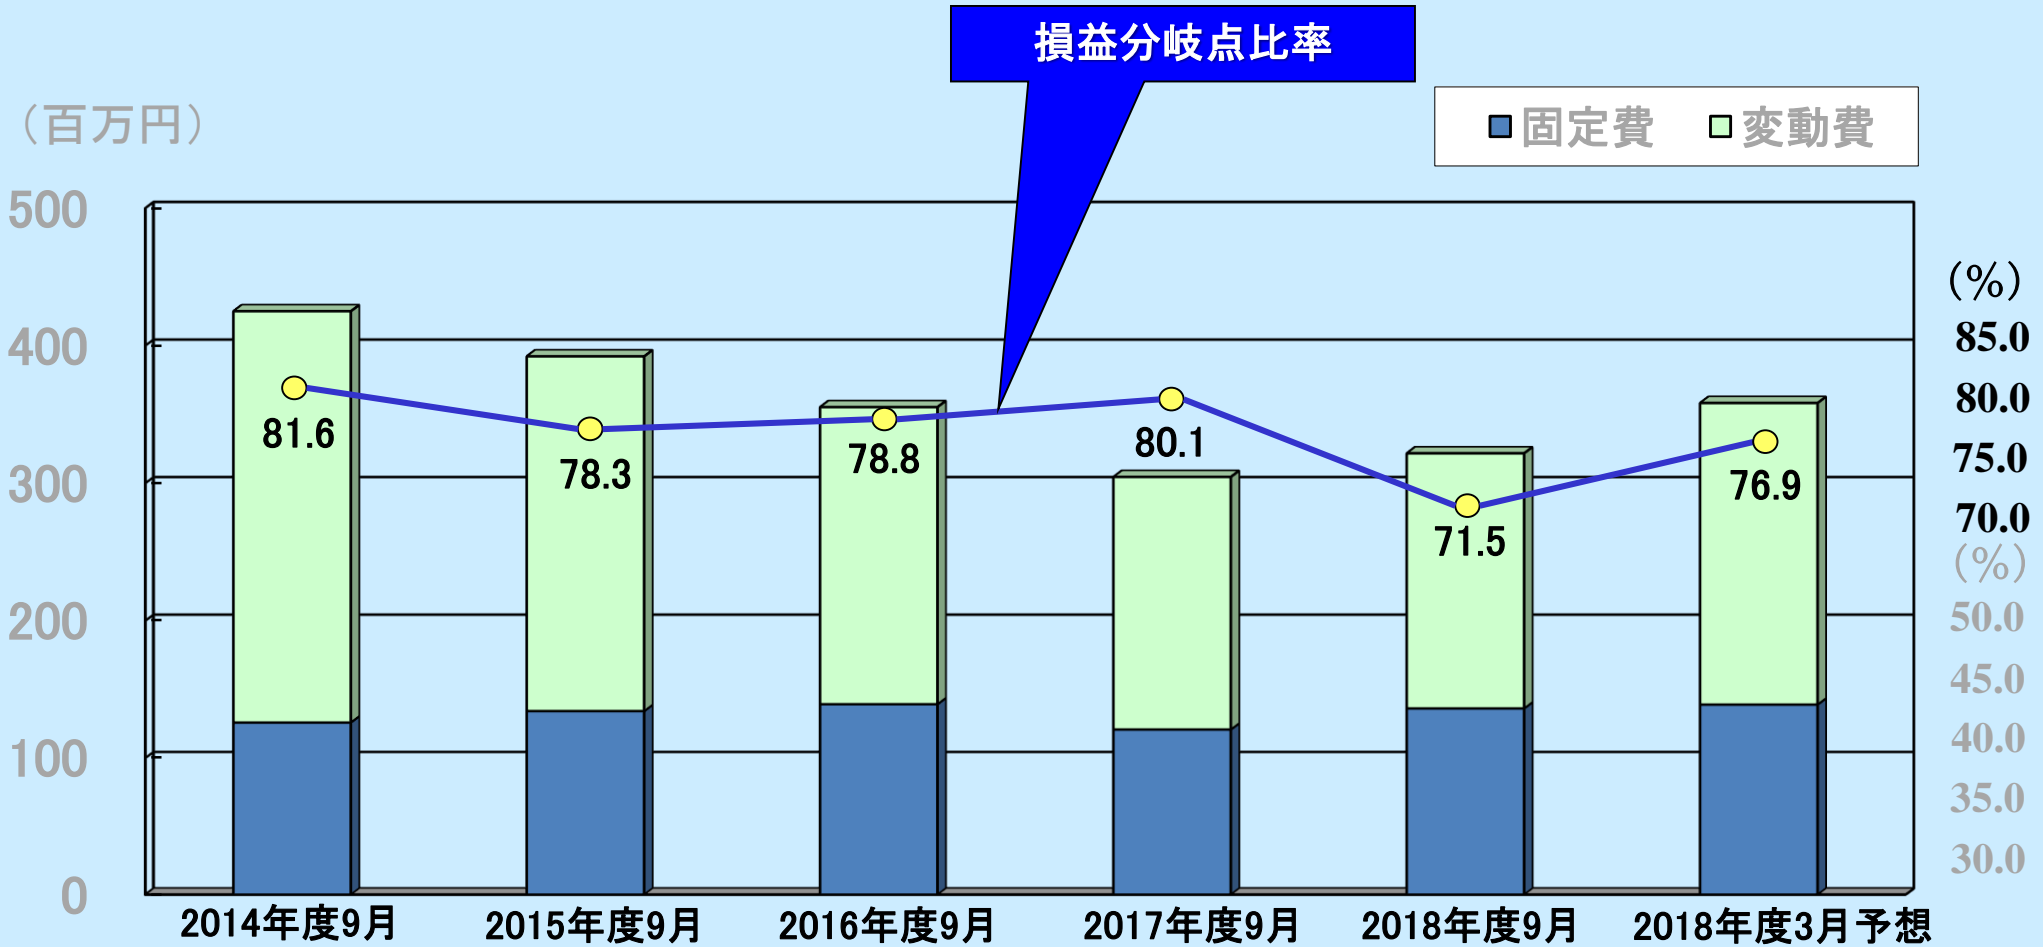

# 損益分岐点の推移

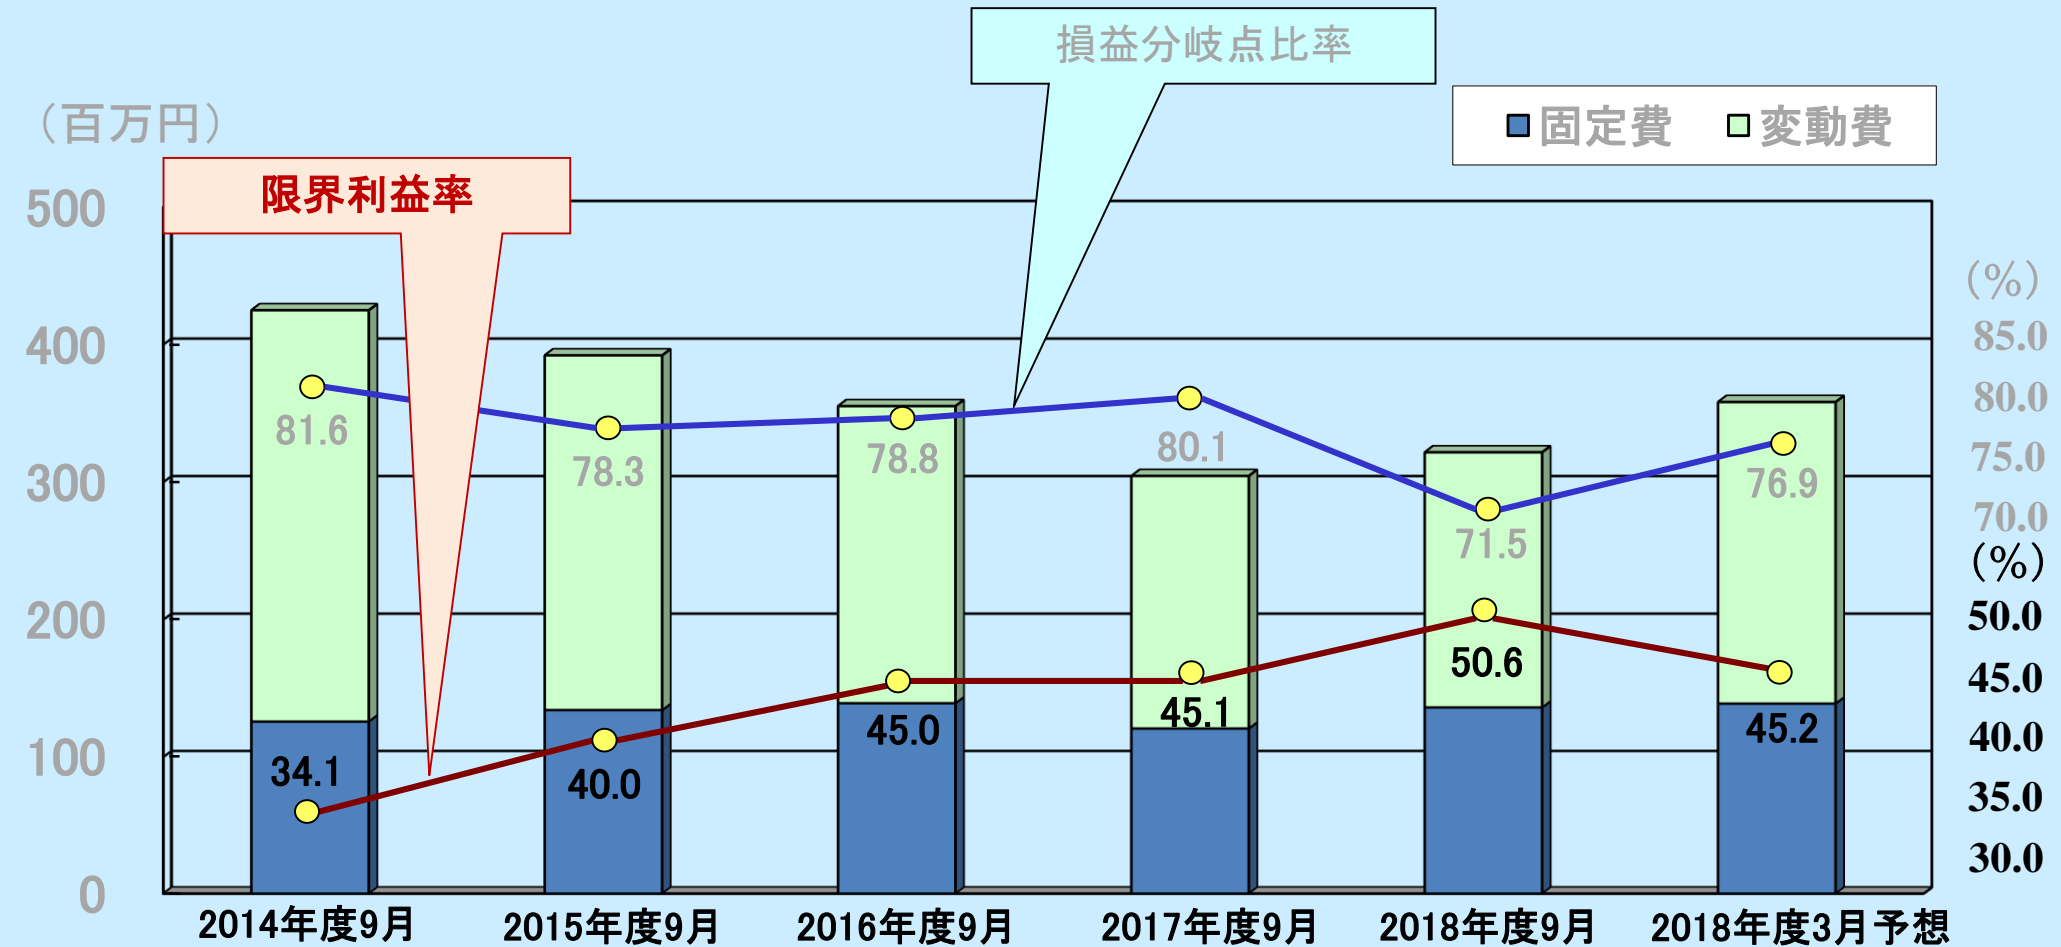

# 有利子負債の状況

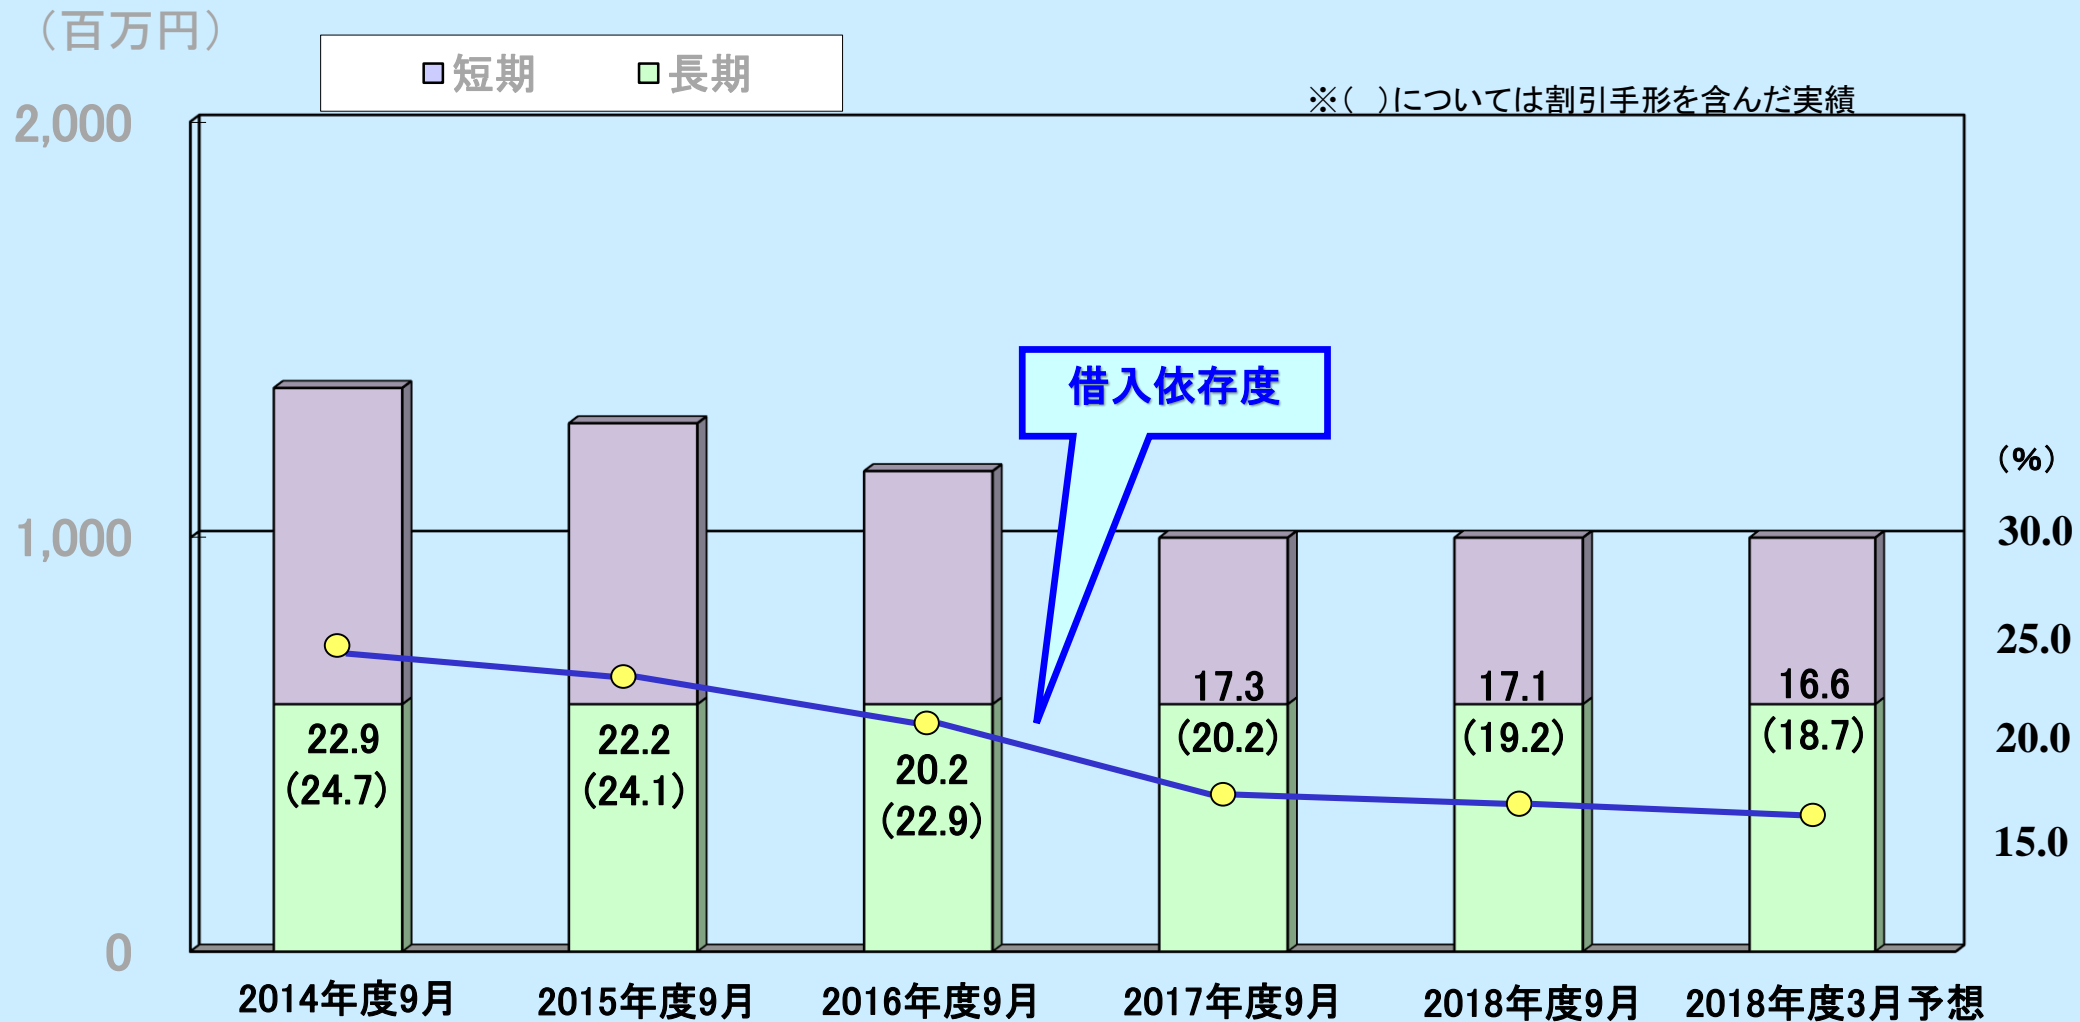

**Creative Power & Innovation**  
Creative Power & Innovation

**KAINOS**  
KAINOS LABORATORIES, INC.